



DIREZIONE GENERALE

Deliberazione n. 235

del 10-03-2015

Oggetto: contratto di manutenzione su Sistema per angiografia Siemens Healthcare, mod. Axiom Artis Zee, Numero di serie n. 135741, Numero di Inventario SIC 6310, in dotazione all'U.O. di Cardiologia Interventistica ed Emodinamica dell'A.O.U.P..

<p>Proposta n. 5 del 24/02/2015</p> <p>Area Facility Management</p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. 8 pagine e n. 1 allegato</i></p> <p>Il Funzionario Istruttore Michele Costagliola</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>Il Responsabile dell'Area Ing. Massimo Noto La Diega</p> <p><i>(Signature)</i></p>	<p>Area Gestione Economico - Finanziaria</p> <p>Autorizzazione spesa n. 28</p> <p>del 25-02-2015</p> <p>Conto di costo C.A.III.03.01</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Responsabile dell'Area Gestione Economico - Finanziaria</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>A.O.U.P. "P. Giaccone" Palermo</p> <p><i>(Circular Stamp)</i></p>
--	---

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita in Sicilia con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

IL CAPO AREA PROPONENTE Ing. Massimo Noto La Diega *(Signature)*

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Renato Li Donni

Nominato con D.P.R.S n. 211/serv.1/S.G. del 04.06.2014

Ai sensi dell'art. 3bis, commi 1 e 2 della Legge Regionale del 28/03/1995, n.22 come aggiunto dall'art 1, comma 1, lettera a) della legge Regionale 2 agosto 2012, n. 43.

Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art.3 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dal D.L.vo n. 517/93 e dal D.L.vo 229/99


del Direttore Amministrativo Dott. Roberto Colletti
e del Direttore Sanitario Dott. Luigi Aprea
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante

Per copia conforme all'originale
Il Dirigente Amministrativo

(Signature)



- VISTO** il Decreto Legislativo n°502 del 30 Dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni operate dai Decreti Legislativi n°517 del 7 Dicembre 1993 e n°229 del 19 Giugno 1999;
- VISTO** il Decreto Legislativo n°517 del 21 Dicembre 1999, che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università;
- VISTO** il Decreto Rettoriale n°264 del 26 Aprile 2000, con il quale viene costituita l'Azienda Ospedaliera Universitaria Paolo Giaccone di Palermo, dotata di autonomia e personalità giuridica;
- VISTA** la Legge Regionale n.5 del 14 Aprile 2009 relativa alle "norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale;
- VISTO** il Decreto dell'Assessorato alla Salute n°10/13 del 9 gennaio 2013;
- VISTO** il D.L. 6 luglio n. 95, contenente "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito con modificazioni nella legge n. 135 del 07 agosto 2012 (**Spending Review**);
- TENUTO CONTO** che n. 1 Sistema per angiografia Siemens Healthcare, mod. Axiom Artis Zee, Numero di serie-n. 135741, Numero di Inventario SIC 6310, in dotazione è in uso presso all'U.O. di Cardiologia Interventistica ed Emodinamica dell'A.O.U.P.;
- CONSIDERATO** la nota del Servizio di Ingegneria Clinica prot. n. 178 del 03/02/2015 nella quale pari servizio dichiara che l'apparecchiatura in parola rientra tra le classi di apparecchi elettromedicali esclusi dalla convenzione CONSIP SIGAE 2;
- CONSIDERATO** che in pari nota il Servizio di Ingegneria Clinica comunica che per quanto di propria conoscenza non vi sono in corso gare centralizzate (regionali, di bacino o consorziate) per l'affidamento della manutenzione dell'apparecchiatura in parola;
- CONSIDERATO** che in pari nota il servizio di Ingegneria Clinica ritiene necessario assicurare sia la manutenzione periodica che la copertura di assistenza tecnica in caso di guasto della apparecchiatura in parola;
- CONSIDERATO** in pari nota il servizio di Ingegneria Clinica chiede di procedere con urgenza alla stipula di un contratto di manutenzione dell'apparecchiatura in parola essendo tra l'altro scaduto il contratto di manutenzione in data 10/01/2015;
- CONSIDERATO** che in pari nota il Servizio di Ingegneria Clinica dichiara che considerata la particolarità dell'apparecchiatura in parola e la complessità di tali sistemi, ritiene opportuno affidare la manutenzione alla ditta Siemens Healthcare, in quanto ditta in grado di offrire l'assistenza di tecnici specializzati e qualificati;



VISTO

il preventivo n. 200356854 del 15/12/2014 della Ditta Siemens Healthcare con sede in V.le Pietro e Alberto Pirelli 10, 20126 Milano P.IVA 00751160151 per un importo complessivo triennale di € 165.000,00 oltre IVA per il contratto di manutenzione triennale del tipo "full risk", n. 1 tubo ad alto vuoto all'anno, n. 1 flat detector e n. 3 attività programmate/anno;

VISTO

che il servizio di Ingegneria Clinica, al fine di ottemperare alla disposizione di "riduzione del 5% degli importi dei contratti in essere per acquisto o fornitura di beni e servizi" di cui al Titolo II – Capo I – Art. 8 della nota prot. 41474 del 21 maggio 2013 del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute, ha provveduto a richiedere alla Ditta Siemens Healthcare con sede in V.le Pietro e Alberto Pirelli 10, 20126 Milano P.IVA 00751160151 una riduzione dell'importo contrattuale pari ad almeno il 5% eliminando dal contratto di manutenzione l'iniettore, l' UPS e la stampante in quanto l'iniettore e la stampante non rientrano tra le classi di apparecchi elettromedicali escluse dalla Convenzione CONSIP SOGAE 2 e l' UPS non rappresenta un bene di alta tecnologia che per sua complessità necessita dell'effettuazione della manutenzione da parte della Ditta Siemens Healthcare;

VISTO

la nota prot. n. M4MK/nr del 07/01/2015 della Ditta Siemens Healthcare con sede in V.le Pietro e Alberto Pirelli 10, 20126 Milano P.IVA 00751160151 con cui pari Ditta ha dichiarato di essere disposta ad applicare un ulteriore sconto del 5% sull'importo totale del canone triennale, pari a € 8.250,00 oltre IVA;

VISTO

che il Servizio di Ingegneria Clinica in pari nota evidenzia che, come dichiarato dalla Ditta Siemens Healthcare con sede in V.le Pietro e Alberto Pirelli 10, 20126 Milano P.IVA 00751160151 con nota del 19/01/2015, la stessa Ditta è l'unica Ditta sul territorio nazionale autorizzata ad intervenire su tutte le proprie apparecchiature con ricambi originali; inoltre, la stessa Ditta dispone di personale tecnico adeguatamente formato, costantemente aggiornato ed in possesso di tutta la documentazione e strumentazione necessaria a garantire l'assistenza tecnica sull'apparecchiatura in parola;

ACQUISITO

il parere di congruità del Servizio di Ingegneria Clinica espresso con nota prot. n. 178 del 03/02/2015 relativo al preventivo n. 200356854 del 15/12/2014 della Ditta Siemens Healthcare con sede in V.le Pietro e Alberto Pirelli 10, 20126 Milano P.IVA 00751160151 per un importo complessivo triennale di € 156.750,00 oltre IVA per il contratto di manutenzione triennale del tipo "full risk", n. 1 tubo ad alto vuoto all'anno, n. 1 flat detector e n. 3 attività programmate/al netto della riduzione di € 8.250,00 oltre IVA pari al 5% di riduzione sull'importo



totale di € 165.000,00 del canone triennale proposto con il preventivo n. 200356854 del 15/12/2014 escludendo dal suddetto contratto l'iniettore, l'UPS e la stampante;

SENTITI

i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;


Per quanto citato in premessa,

DELIBERA

- 1) di approvare la spesa inerente al preventivo di spesa n. 200356854 del 15/12/2014 della Ditta Siemens Healthcare con sede in V.le Pietro e Alberto Pirelli 10, 20126 Milano P.IVA 00751160151 per un importo complessivo triennale di € 156.750,00 oltre IVA per il contratto di manutenzione triennale del tipo "full risk", n. 1 tubo ad alto vuoto all'anno, n. 1 flat detector e n. 3 attività programmate/anno al netto della riduzione di € 8.250,00 oltre IVA pari al 5% di riduzione sull'importo totale di € 165.000,00 del canone triennale proposto con il preventivo n. 200356854 del 15/12/2014 escludendo dal suddetto contratto l'iniettore, l'UPS e la stampante;
- 2) di trasmettere la presente delibera all'Area Gestione Economica Finanziaria dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone, affinché l'importo relativo al preventivo di spesa n. 200356854 del 15/12/2014 della Ditta Siemens Healthcare con sede in V.le Pietro e Alberto Pirelli 10, 20126 Milano P.IVA 00751160151 per un importo complessivo triennale di € 156.750,00 oltre IVA per il contratto di manutenzione triennale del tipo "full risk", n. 1 tubo ad alto vuoto all'anno, n. 1 flat detector e n. 3 attività programmate/anno al netto della riduzione di € 8.250,00 oltre IVA pari al 5% di riduzione sull'importo totale di € 165.000,00 del canone triennale proposto con il preventivo n. 200356854 del 15/12/2014 escludendo dal suddetto contratto l'iniettore, l'UPS e la stampante possa essere impegnato sul conto di costo C.A.III.03.01 "Manutenzioni attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie" secondo quanto di seguito riportato:
 - anno 2015 € 52.250,00 IVA esclusa;
 - anno 2016 € 52.250,00 IVA esclusa;
 - anno 2017 € 52.250,00 IVA esclusa
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione, per l'esecuzione e quant'altro di competenza, alle seguenti articolazioni organizzative aziendali:
 - Area Economico Finanziaria;
 - Servizio di Ingegneria Clinica;
- 4) di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo.




Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone

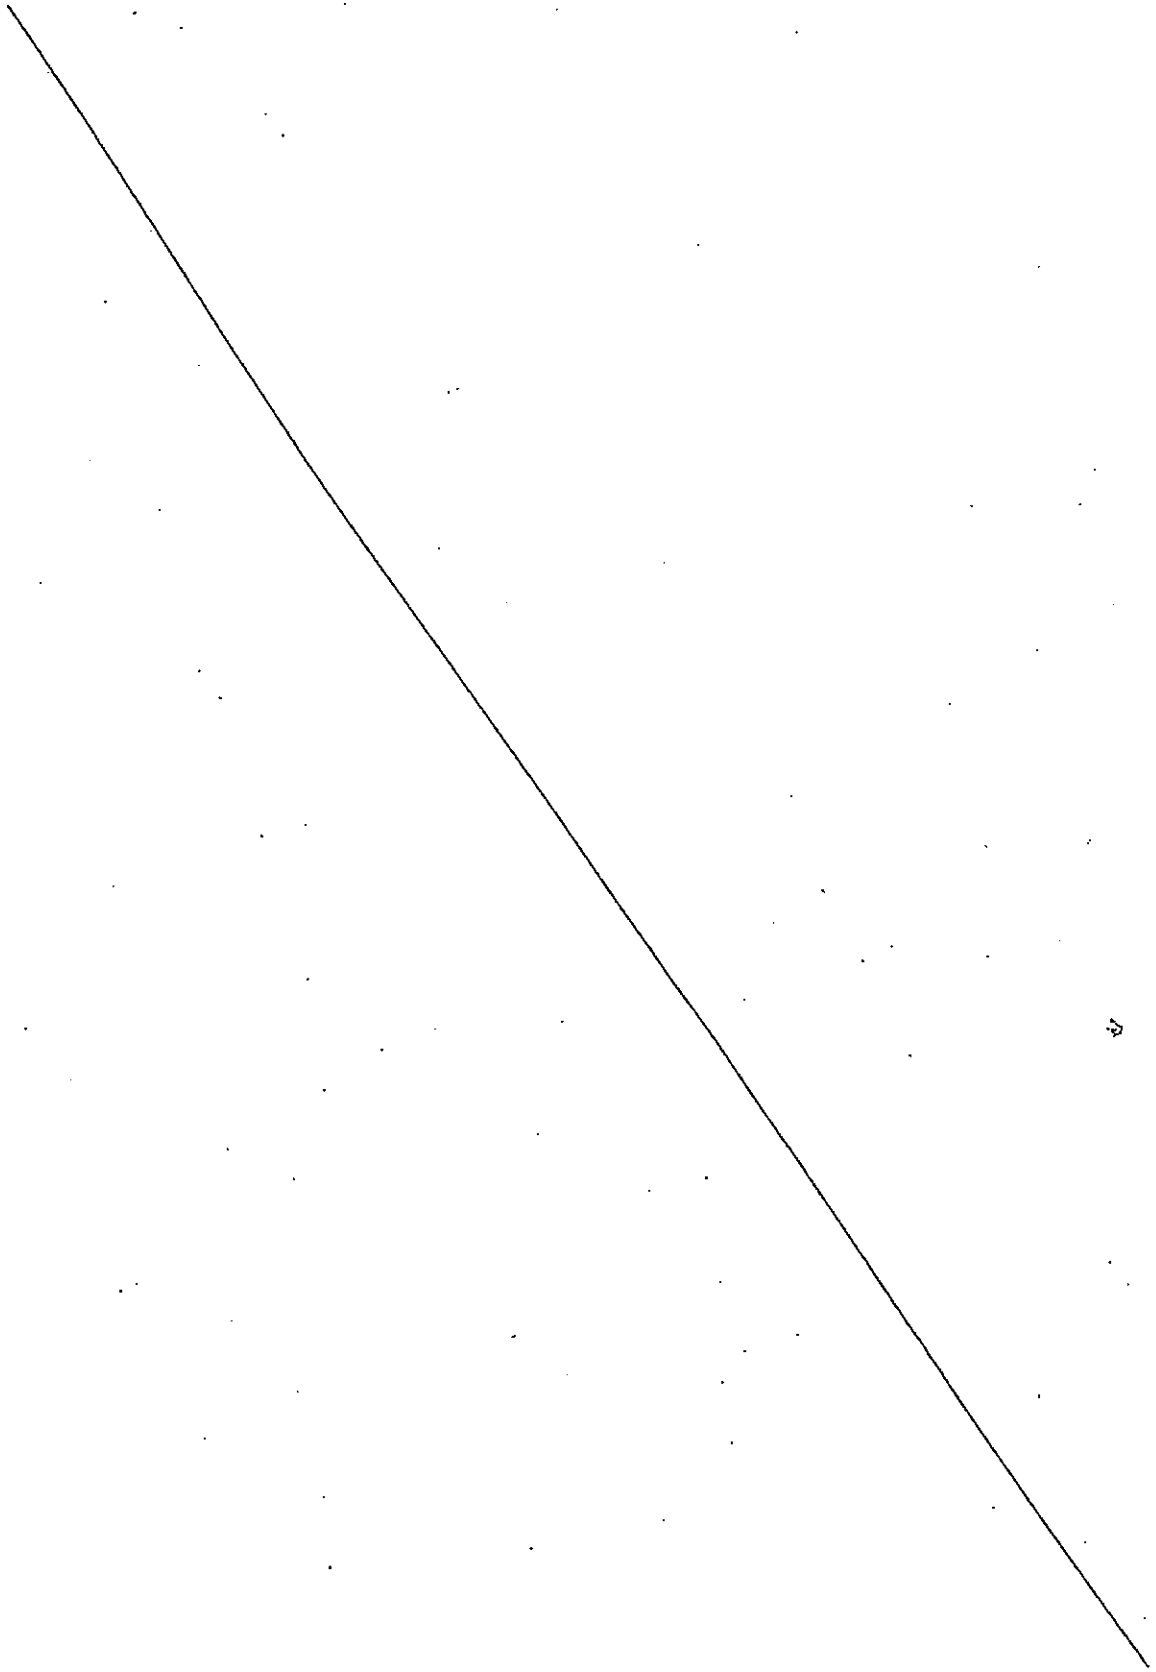




Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone

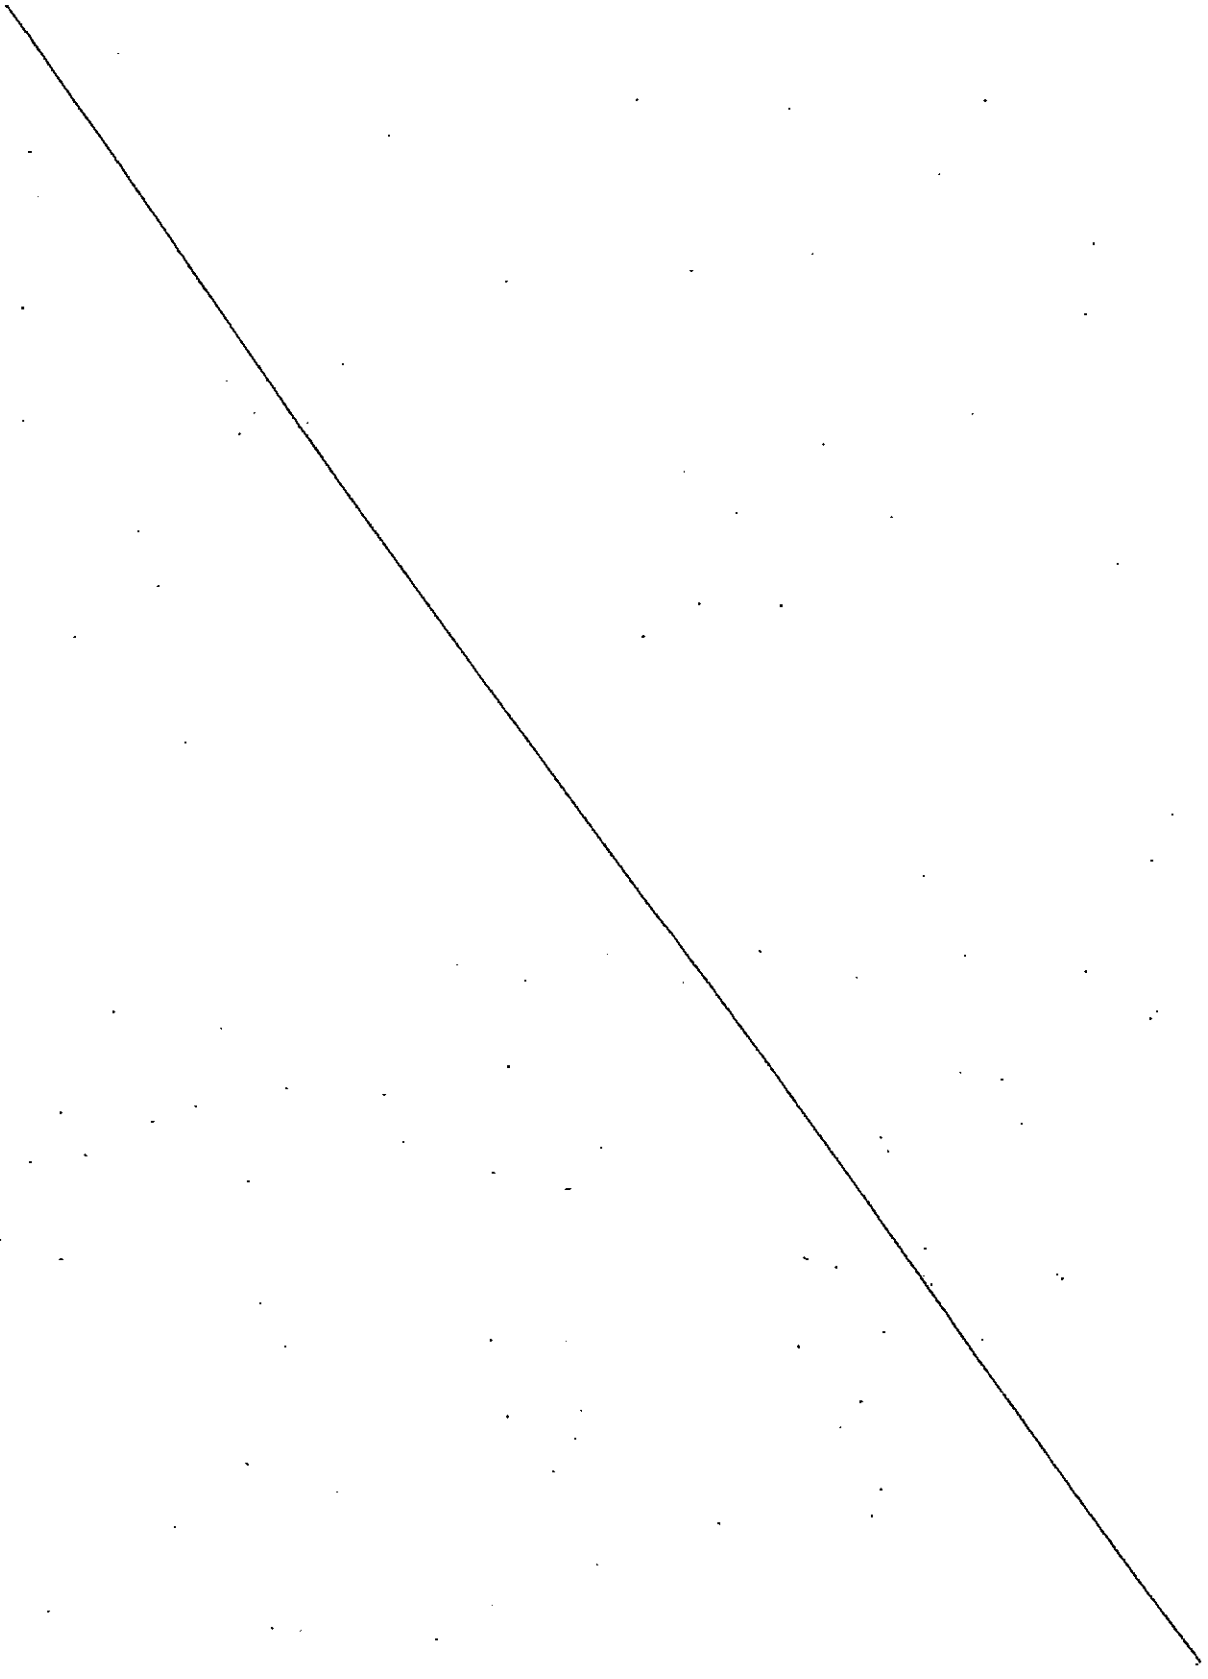



Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone

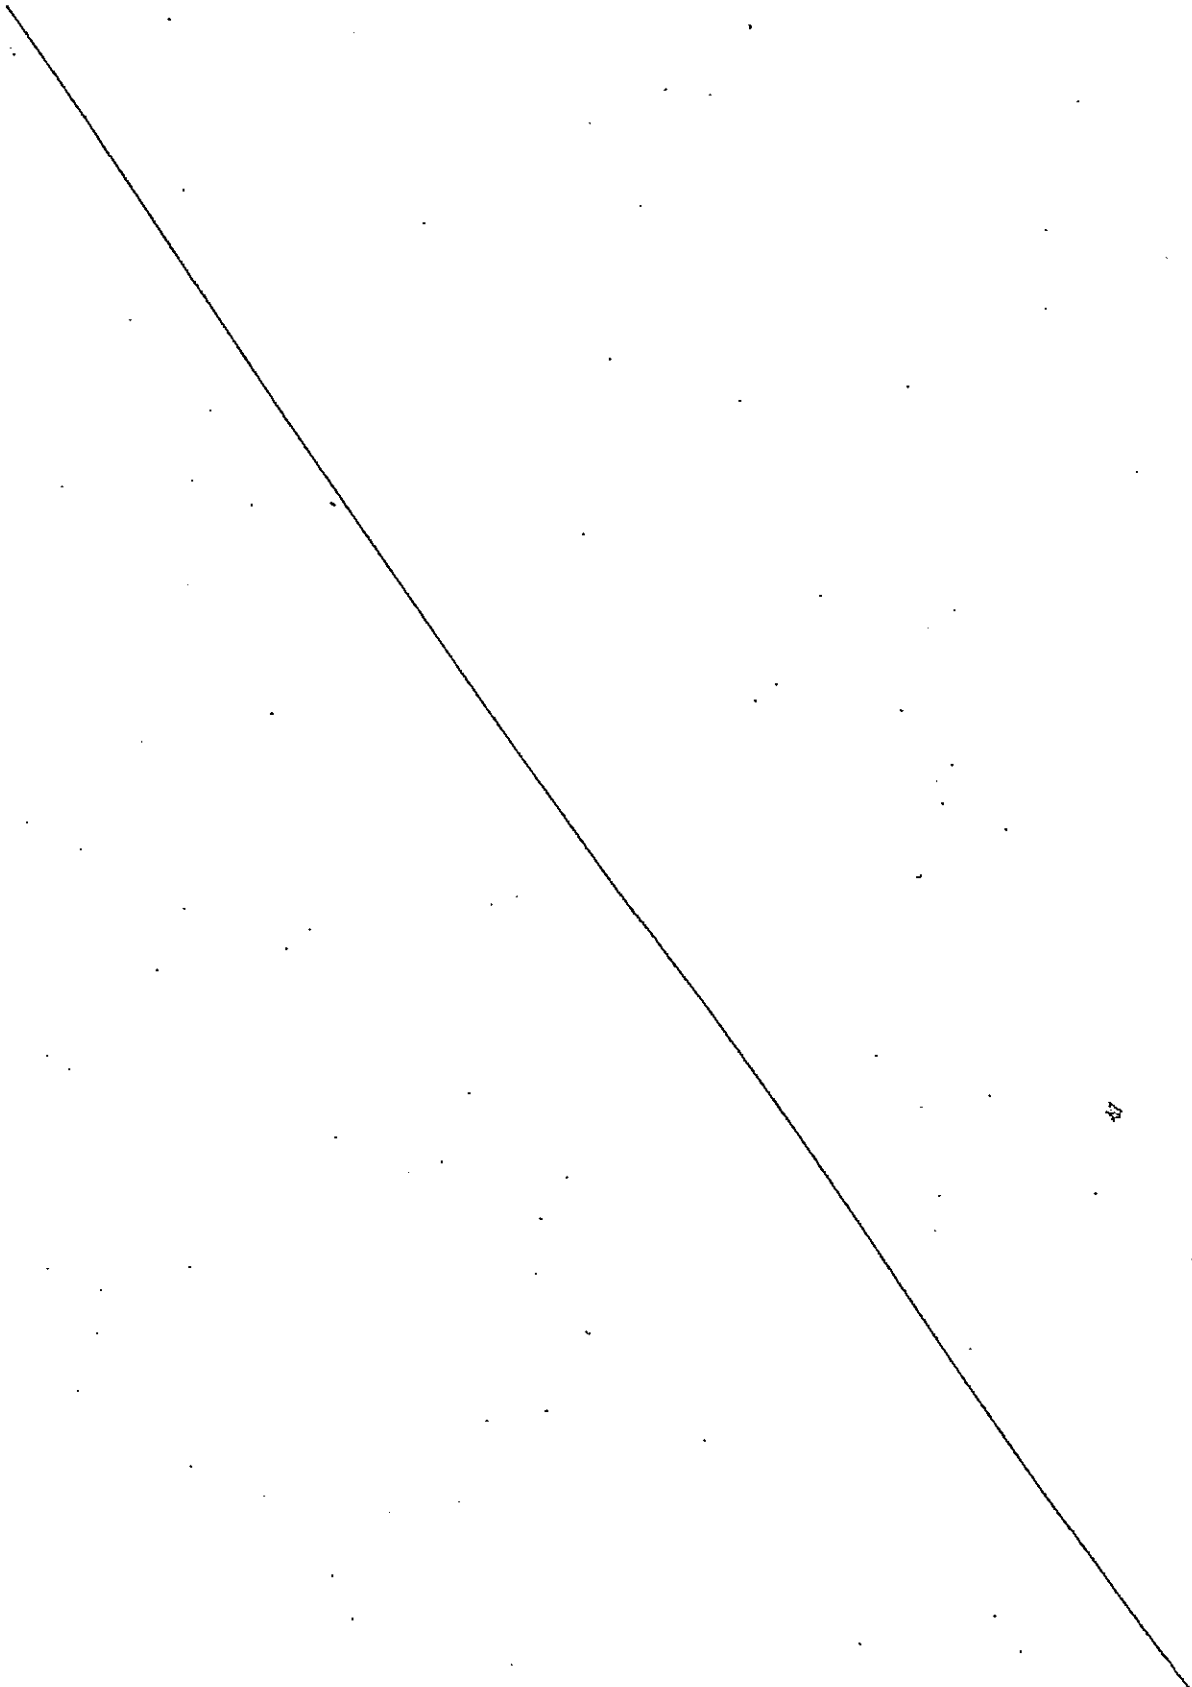



Il Direttore Amministrativo
Dott. Roberto Colletti

Il Direttore Sanitario
Dott. Luigi Aprea

Il Direttore Generale
Dott. Renato Li Donni

Segretario Verbalizzante

ESTREMI ESECUTIVITA'	PUBBLICAZIONE
<input type="checkbox"/> Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 6. Ufficio Atti Deliberativi Il Responsabile	Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art.53 comma 2, a decorrere dal 10-03-2015 e fino al 08-04-2015 Ufficio Atti Deliberativi
<input type="checkbox"/> Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.	La presente Delibera è stata registrata nell'apposito registro del Collegio Sindacale Ufficio Atti Deliberativi
<input type="checkbox"/> Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.28 comma 6 legge regionale 26 marzo 2002 n.2 è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi della L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.	

La presente deliberazione è composta da n. 8 pagine e n. 1 allegato

NOTE: