



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA  
 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO  
 U.O.C. Area Tecnica  
 Direttore: Dott.ssa Giovanna Milisenda  
 Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo  
 Tel. 091.6553002  
 Email: area.tecnica@policlinico.pa.it  
 Web: www.policlinico.pa.it CF e P.IVA: 05841790826

Palermo, 22/07/2025

Al Direttore dell'U.O.C. Diagnostica per Immagini e  
 Interventistica  
 Prof.re Giuseppe Brancatelli

E, p.c. Al Direttore dell'Area Economico  
 Finanziaria e Patrimoniale f.f.  
 Dott. Vincenzo Manzella

U.O.C. Area Economico Finanziaria e Patrimoniale  
 Dott.ssa Nadia Bilello  
 Tinaglia Epifania

U.O.S.D. Radioprotezione Medica  
 Ing. Alessandro D'Aquila  
 Dott. Gaetano Arnetta

**Oggetto: Parere tecnico di dismissione di N. 1 DENSITOMETRO OSSEO, marca HOLOGIC INC, modello DISCOVERY SL, s/n: 80290 (6255) e sic 0001885 e relativi aggregati SIC 0001886 - SIC 0001887 – SIC 0001889 ubicato presso l' U.O.C. Neurologia**

Relativamente all' apparecchiatura di seguito indicata con relativi aggregati:

INV SIC	APPARECCHIATURA	PRODUTTORE	MODELLO	Numero Seriale	DESCRIZIONE REPARTO DI UBICAZIONE
0001885	DENSITOMETRO OSSEO	HOLOGIC INC	DISCOVERY SL	80290 (6255)	U.O.C. NEUROLOGIA
0001886	PERSONAL COMPUTER	HOLOGIC INC	010-1545	10537	U.O.C. NEUROLOGIA
0001887	PC, STAMPANTE PER	HEWLETT PACKARD CO	HP BUSINESS INKJET 2280	MY37931148	U.O.C. NEUROLOGIA

0001889	CARRELLO SERVITORE ELETRIFICATO	NON RILEVATO O CODIFICATO	010-1474	N.D.	U.O.C. NEUROLOGIA
---------	------------------------------------	------------------------------	----------	------	-------------------

Tenuto conto che l' apparecchiatura è obsoleta e come tale non più assistita e assistibile a causa dell' indisponibilità delle parti di ricambio necessarie al ripristino funzionale ,e preso atto della comunicazione pervenuta dalla ditta Polygon Spa, che cura la manutenzione di alcune apparecchiature elettromedicali per conto di questa A.O.U.P., pervenuta alla scrivente con Nota Prot. n. 0044003 del 18.07.2025 che si rimette in allegato, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento per la gestione dell'inventario e del fuori uso dei beni di proprietà dell'A.O.U. "P. Giaccone di Palermo", approvato con delibera n. 1102 del 09/12/2015 , con la presente si comunica il parere tecnico di dismissione dell' apparecchiatura indicata in parola.

Si invita il Responsabile dell'Unità Operativa, qualora tale bene fosse presente nell'inventario patrimoniale aziendale, a comunicare la dismissione di che trattasi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questa A.O.U.P., al fine di consentire allo stesso di avviare le procedure di dismissione/discarico del bene in oggetto. Nel caso in cui tale bene fosse di proprietà universitaria, si chiede di avviare le procedure per la dismissione/discarico dello stesso sulla base del regolamento predisposto dall'Università degli Studi di Palermo.

A seguito della predisposizione dell'atto deliberativo di dismissione da parte del Dirigente Amministrativo ed alla cancellazione del bene, il Direttore dell'U.O. potrà richiedere la rimozione e lo smaltimento dell' apparecchiatura di che trattasi.

Si raccomanda, al Responsabile dell'Unità Operativa, di mettere il bene in fuori uso e verificare la corretta apposizione dell'opportuna targhetta "APPARECCHIATURA IN FUORI USO" predisposta dalla suddetta ditta.

Infine, nel caso in cui tale apparecchiatura fosse necessaria per garantire il proseguo dell'attività ad essa connessa, si invita il Responsabile dell'Unità Operativa a farne opportuna richiesta di reintegro agli Uffici competenti.

Distinti saluti.

Il RUP  
Geometra Carmelo Lanza

Il DEC  
Geometra Aldo La Rosa

F.to Ing. Marika Pia Scozzaro

F.to Ing. Antonella Federico

Firmato da Marika Pia Scozzaro  
Data 22-07-2025


Firmato da Antonella Federico  
Data 22-07-2025

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICINICO "P. GIACCONI"

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICINICO "P. GIACCONI"

Il Direttore dell' U.O.C. Area Tecnica

Dot.ssa Giovanna Milisenda

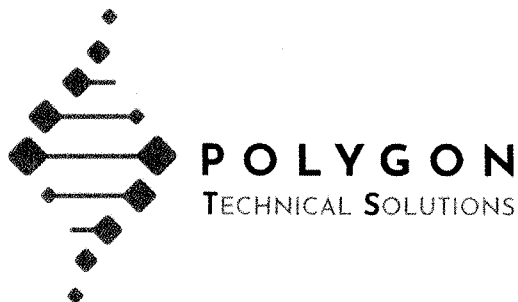

Prot. n. 132/2025

Palermo 18/07/2025

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna

Geom. Aldo La Rosa (D.E.C)

**OGGETTO: Affidamento dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Sicilia, mediante convenzione della durata di anni 5 (II edizione). Numero Gara ANAC 8453328 - CIG derivato B6642EFBBB, recepita dall'AOUP P.Giaccone con delibera N.423/2025 del 18/04/2025. Proposta di dismissione per apparecchiatura tipologia DENSITOMETRO OSSEO, marca: HOLOGIC, modello DISCOVERY SL s/n: 80290 (6255) e sic 0001885 ubicata presso l'UOC NEUROLOGIA**

Facendo seguito alla richiesta di intervento pervenuta dal reparto in oggetto (ODL 173944), con la presente siamo a comunicare quanto segue:

il nostro personale tecnico, ha riscontrato malfunzionamento del densitometro (fallisce controlli QC - All.1 -), ed ha pertanto provveduto a richiedere i necessari ricambi alla casa madre ditta Hologic SPA.

Come da ns precedente comunicazione prot 065/2025, la suddetta ditta ha già comunicato l'End of Service del modello DISCOVERY per indisponibilità di parti di ricambio reperibili in commercio ( - All. 2 -)


Per quanto su esposto, con la presente proponiamo la dismissione dell'apparecchiatura e dei suoi aggregati (PERSONAL COMPUTER inventario sic 0001886, PC STAMPANTE PER inventario sic 0001887, CARRELLO SERVITORE ELETTRIFICATO inventario sic 0001889) per impossibilità di ripristinare il corretto funzionamento, a far data dal 08/07/2025.

Vi chiediamo pertanto di attivare urgentemente, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per il fuori uso della stessa.

Sicuri di una Vs. sollecita attivazione nel merito e a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

**Polygon SpA**

(ing. Francesco Macaluso)

  
**Polygon S.p.A.**  
 Via Laurentina 456/458  
 00144 Roma  
 P. Iva 06915071002

ALLEGATI

- All.1: ns odl 173944
- All.2: comunicazione EOS HOLOGIC

Sede legale: Via Laurentina, 456/458 - 00142 Roma (RM) - Tel +39.06514081 - Fax +39.0651408214 - Partita IVA e C.F. n° 06915071002  
 R.E.A. n° 998707 Cap. Soc. € 6.480.000,00 I.v. Sede operativa: Via Gasparo Gozzi, 1/A - 20129 Milano (MI) - Tel +39.02928580 - Fax +39.0292858002  
 www.polygon.eu - info.is@polygon.it

UNI EN ISO 9001  
UNI ISO 45001

Società con Sistema di Gestione Certificato secondo  
UNI CEI EN ISO 13485    UNI EN ISO 14001  
UNI EN ISO 37001    SA 8000

UNI EN ISO 27001  
UNI PDR 125

**Presidio** A.O.U. PAOLO GIACCONE  
**Centro di Costo** UOC Neurologia  
**Reparto Ubicazione** NEUROLOGIA E RIABILITAZIONE NEUROLOGICA  
**Ubicazione**  
**Richiedente** DARICELLO **Riferimento** **Tel**  
**Nr. Inventario** 0001885 DENSITOMETRO OSSEO  
**Sistema** 0001885 DENSITOMETRO OSSEO  
**Produttore** HOLOGIC INC  
**Modello** DEOHLGSL DISCOVERY SL  
**Numero di serie** 80290 (6255) **Forma Presenza** ALTRO **Stato** NORMAL  
**Data/Ora Richiesta** 01/07/2025 13:53:00 **Richiesta Nr.** RDL0027711  
**Data/Ora Risposta** 01/07/2025 13:53:00 **Data/Ora INIZIO** 07/07/2025 08:45:10  
**Data Concordata** 07/07/2025 09:00:00 **Data/Ora FINE** 08/07/2025 10:15:44  
**Stato ODL** Intervento Terminato  
**Tipo** Manutenzione Correttiva  
**Segnalazione** NON EFFETUA LA CALIBRAZIONE


**AZIONI ESEGUITE**

Addetto	Attività	Ruolo	Data ora inizio	Data ora fine
GIUSEPPE PLANCES	Ore Lavoro	Operatore principale	07/07/2025 08:45:10	07/07/2025 11:45:16
TIPO: Intervento non risolutivo NOTE: verifica guasto, fallisce controllo QC, smontaggio, eseguita pulizia da olio finestra tubo, controllo cinghie e connessioni, montaggio, prove non positive, si richiedono ricambi.				
MARCO GERACI	Ore Lavoro	Operatore principale	07/07/2025 08:45:10	07/07/2025 11:45:16
TIPO: null NOTE: null				
GIUSEPPE PLANCES	Ore Lavoro	Operatore principale	08/07/2025 08:10:47	08/07/2025 10:15:44
TIPO: Intervento risolutivo NOTE: eseguito nuovo controllo, non risolutivo, si riceve comunicazione da cm, di End of Life, parti di ricambio non più disponibili, si comunica al sici la messa in fuori uso del sistema.				


**Note:**  
**PNICOLOSI - 01-07-2025 15:03:59, DARICELLO - 01-07-2025 15:03:19**

**NON EFFETUA LA CALIBRAZIONE**

Tecnico:  
plances



Referente:  
Giuffrè



Data firma:08/07/2025



**PRODUCT END OF SERVICE NOTICE**  
**For Discovery® DXA System**

April 2024

Dear Customer:

Our ambition to be the leading manufacturer of Women's Health products is a goal that cannot be achieved without you. To achieve this, we are dedicated to delivering the highest quality service, product support and technologically advanced products.

In December 2018, we announced the end of life of our Discovery® DXA system with the commitment to provide service as available for 7 years from the date of purchase. Due to resource and supply constraints, **we will no longer provide service for these systems after December 31, 2024**. Replacement parts and onsite support will no longer be available. Phone support following this date will be limited and cannot be guaranteed due to the age of the product and the need to support our active product lines.

We will continue to honor any remaining service contracts in place after December 31, 2024, to the best of our ability dependent on the availability of service parts. Additionally, no renewals or extensions will be available.

We encourage you to contact your local Hologic representative, for additional information about alternative products including our Horizon® DXA system. The Horizon® DXA system is a multi-faceted system that can help clinicians assess bone health, body composition and cardiovascular health.

For more information, please visit [Hologic.com/Skeletal-Health](https://www.hologic.com/Skeletal-Health).

We at Hologic look forward to continuing to partner with you to serve you and your patients. We remain committed to providing the highest-quality products and service.

Sincerely,

*Lisa Rudnick*

Sr. Director, Global Services Commercial

---